

EN
Prior to use, carefully read the instructions for use.


G-CEM™ Veneer LIGHT-CURED ADHESIVE RESIN CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE Adhesive luting of ceramic and composite veneers, inlays and onlays with a thickness (< 2mm) and translucency that enables the complete light-curing of the cement.

CONTRAINDICATIONS 1. Direct pulp capping. 2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacryate monomer or methacrylate polymer.

HOW TO USE G-CEM Veneer SYRINGE a) Hold the syringe upright and remove the wing cap by turning counter-clockwise.

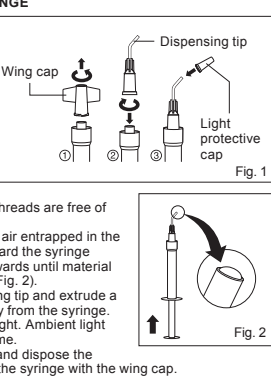

CEMENTATION PROCEDURE OF VENEERS, INLAYS, ONLAYS 1. TRIAL FIT OF THE RESTORATION a) Remove the temporary restoration and clean the prepared tooth using a brush and pumice slurry to remove any remaining temporary cement.

DE
Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen!


G-CEM™ Veneer LICHTHARTENDE ADHÄSIVER KUNSTSTOFFZEMENT

Darf nur von einem Zahnarzt bei den angegebenen Indikationen verwendet werden.

INDIKATIONEN Adhäsive Befestigung von Keramik- und Komposit-Veneers, Inlays und Onlays (< 2 mm) und einer Transluzenz welche die komplette Lichthardtung des Zementes ermöglicht.

GEGENANZEIGEN 1. Direkte Pulpaüberkapping. 2. Dieses Produkt darf nicht an Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen Methacryatmonomere oder Methacryatpolymer haben.

SO VERWENDEN SIE DIE TRY-IN PASTE VON G-CEM Veneer SPRITZE a) Halten Sie die Spritze aufrecht und entfernen Sie die Flügelschutzkappe nach dem Umdrehen des Lichtschutzverschlusses gegen den Uhrzeigersinn.

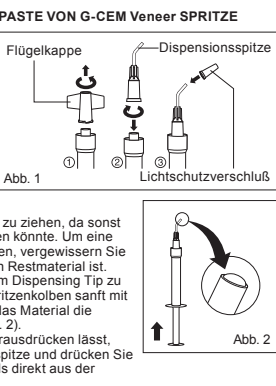

BEFESTIGUNG VON VENEERS, INLAYS, ONLAYS 1. TRIALE PASSUNG DER RESTAURATION a) Entfernen Sie die temporäre Restauration und reinigen Sie den präparierten Zahn unter Verwendung einer Bürste und Bismutslurrie, um Reste von temporärem Zement zu entfernen.

FR
Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi.


G-CEM™ Veneer COLLE COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE

Utilisation seulement par un professionnel dentaire et selon les indications.

INDICATIONS Collage de céramique et onlays, facettes composites et céramique avec une épaisseur (< 2.0mm) et une translucidité qui permet la photopolymérisation complète de la colle.

CONTRAINDICATIONS 1. Coffrage pulpaire direct. 2. Éviter d'utiliser ce produit chez des patients présentant une allergie connue aux monomères ou polymères de méthacrylates.

COMMENT UTILISER LA SERINGE G-CEM Veneer a) Tenir la seringue verticalement et retirer le capuchon en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

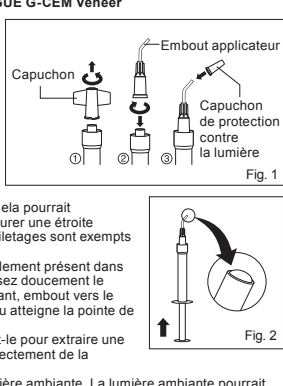

PROCEDURE DE COLLAGE DES FACETTES, INLAYS, ONLAYS 1. ESSAI D'ADAPTATION DE LA RESTAURATION a) Vérifier l'ajustement de la restauration avant de commencer la pose.

IT
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.


G-CEM™ Veneer CEMENTO RESINOSO ADESOIVO FOTOPOLIMERIZZABILE

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI PER L'USO Cementazione adesiva di faccette, inlay e onlay in ceramica e in composito con uno spessore (<2.0 mm) e una traslucenza tali da consentire la completa fotopolimerizzazione della colla.

CONTRAINDICAZIONI 1. Incaucappuccio diretto della pulpa. 2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie ai monomeri o polimeri di metacrilato.

COME USARE G-CEM Veneer SIRINGA a) Tenere la siringa in posizione verticale e togliere il cappuccio rotondo ruotando la punta sia ben inserita, verticalmente nella fessura della siringa ruotandola in senso orario.

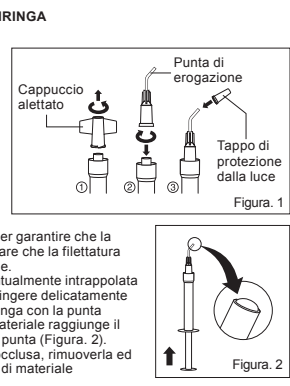

PROCEDURA PER LA CEMENTAZIONE DI FACCETTE, INLAY E ONLAY 1. PROVA DI ADATTAMENTO DELLA RESTAURAZIONE a) Rimuovere il tappo provvisorio e pulire il dente preparato utilizzando uno spazzolino e pasta pomice per togliere l'eventuale residuo di cemento temporaneo.

ES
Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso.


G-CEM™ Veneer CEMENTO DE RESINA ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS Cementación adhesiva de carillas de cerámica o de composito, inlays y onlays con un espesor de (< 2.0 mm) y una translucencia que permita la completa fotopolimerización de la resina de la cola.

CONTRAINDICACIONES 1. Recubrimiento directo a la pulpa. 2. Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas a monómero de metacrilato o polímeros de metacrilato.

CÓMO USAR LA JERINGA G-CEM Veneer a) Mantenga la jeringa en posición vertical y retire el tapón grande hacia la izquierda.

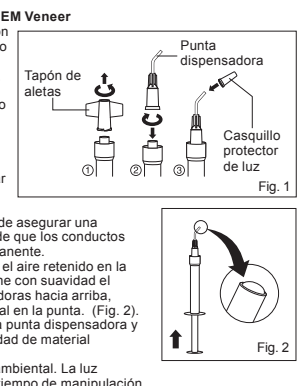

PROCEDIMIENTO DE CEMENTACIÓN PARA CARILLAS, INLAYS, ONLAYS 1. PRUEBA DE AJUSTE DE LA RESTAURACIÓN a) Retirar la restauración provisional y limpiar el diente preparado usando un cepillo de dientes y pasta de dientes para quitar cualquier resto de cemento provisional.

NL
Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.


G-CEM™ Veneer LICHTHARTEND ADHESIEF KUNSTHARTSCHEMEL

Alleen te gebruiken door een tandheerkskundig gekwalificeerde(n) in de vermelde toezichtgebieden.

INDICATIES Adhäsief hechten van keramische en composietveneers, inlays en onlays met een dikte (<2 mm) en een translucentie dat volledige lichthardtning mogelijk maakt.

CONTRA-INDICATIE 1. Directe pulpoverkapping. 2. Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarbij bekend is dat ze allergisch zijn voor methacrylat monomeer of methacrylat polymer.

HOE HET G-CEM Veneer SPRUITJE TE GEBRUIKEN a) Hou het spuitje verticaal vast en draai het grote dopje met de beschermende afdekking naar links totdat de doppeleer het spuitje heeft verplaatst.

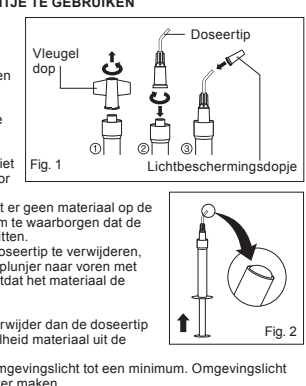

BEVESTIGINGSPROCEDURE VOOR VENEERS, INLAYS, ONLAYS 1. DIRECTE PULPAOVERKAPPING a) Verwijder de tijdelijke voorziening en reinig het geprepareerde element met een borsteltje en pastafles op voorhand met het lichtgecureerde cement verwijderen.

Check if red, shade and occlusion of the final restoration. 3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION a) Clean the preparation with pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Selective etching of enamel. c) Apply G-Prémio Bond for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Check if red, shade and occlusion of the final restoration. 3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION a) Clean the preparation with pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Selective etching of enamel. c) Apply G-Prémio Bond for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Check if red, shade and occlusion of the final restoration. 3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION a) Clean the preparation with pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Selective etching of enamel. c) Apply G-Prémio Bond for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Check if red, shade and occlusion of the final restoration. 3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION a) Clean the preparation with pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Selective etching of enamel. c) Apply G-Prémio Bond for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Check if red, shade and occlusion of the final restoration. 3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION a) Clean the preparation with pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Selective etching of enamel. c) Apply G-Prémio Bond for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Check if red, shade and occlusion of the final restoration. 3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION a) Clean the preparation with pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Selective etching of enamel. c) Apply G-Prémio Bond for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Table 1 - G-Prémio Bond Irradiation Time. Light curing unit: < 10 mm > 10 mm. Halogen/LED >700 mW/cm²: 10 sec. 20 sec. High power LED >1,200 mW/cm²: 5 sec. 10 sec.

Table 1 - G-Prémio Bond Belichtingsduur. Lichtstrahlbreedte: < 10 mm > 10 mm. Halogen/LED >700 mW/cm²: 10 sek. 20 sek. Hocholeistungs-LED >1,200 mW/cm²: 5 sek. 10 sek.

Table 1 - G-Prémio Bond Temps d'irradiation. Temps d'irradiation: < 10 mm > 10 mm. Lampe à photopolymériser: 10 sec. 20 sec. Halogen/LED >700 mW/cm²: 10 sec. 20 sec. LED puissance >1,200 mW/cm²: 5 sec. 10 sec.

Table 1 - G-Prémio Bond Tiempo de irradiación. Tiempo de irradiación: < 10 mm > 10 mm. Lámpara fotopolimerizante: 10 seg. 20 seg. Halógeno/LED >700 mW/cm²: 10 seg. 20 seg. Alta potencia LED >1,200 mW/cm²: 5 seg. 10 seg.

Table 1 - G-Prémio Bond Belichtingsduur. Belichtingsduur: < 10 mm > 10 mm. Halogen/LED >700 mW/cm²: 10 sec. 20 sec. Hocholeistungs-LED >1,200 mW/cm²: 5 sec. 10 sec.

Table 1 - G-Prémio Bond Belichtingsduur. Belichtingsduur: < 10 mm > 10 mm. Halogen/LED >700 mW/cm²: 10 sec. 20 sec. Hocholeistungs-LED >1,200 mW/cm²: 5 sec. 10 sec.

4. CEMENTATION a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement. b) Seal the veneer immediately after the preparation, exerting moderate pressure. c) Remove excess cement using one of the techniques below: i. Keep moderate pressure and remove excess cement using a brush. Make sure that excess cement is thoroughly removed from areas of difficult access (e.g. interproximal areas).

4. CEMENTATION a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement. b) Seal the veneer immediately after the preparation, exerting moderate pressure. c) Remove excess cement using one of the techniques below: i. Keep moderate pressure and remove excess cement using a brush. Make sure that excess cement is thoroughly removed from areas of difficult access (e.g. interproximal areas).

4. CEMENTATION a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement. b) Seal the veneer immediately after the preparation, exerting moderate pressure. c) Remove excess cement using one of the techniques below: i. Keep moderate pressure and remove excess cement using a brush. Make sure that excess cement is thoroughly removed from areas of difficult access (e.g. interproximal areas).

4. CEMENTATION a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement. b) Seal the veneer immediately after the preparation, exerting moderate pressure. c) Remove excess cement using one of the techniques below: i. Keep moderate pressure and remove excess cement using a brush. Make sure that excess cement is thoroughly removed from areas of difficult access (e.g. interproximal areas).

4. CEMENTATION a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement. b) Seal the veneer immediately after the preparation, exerting moderate pressure. c) Remove excess cement using one of the techniques below: i. Keep moderate pressure and remove excess cement using a brush. Make sure that excess cement is thoroughly removed from areas of difficult access (e.g. interproximal areas).

4. CEMENTATION a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement. b) Seal the veneer immediately after the preparation, exerting moderate pressure. c) Remove excess cement using one of the techniques below: i. Keep moderate pressure and remove excess cement using a brush. Make sure that excess cement is thoroughly removed from areas of difficult access (e.g. interproximal areas).

5. FINAL POLISHING Polish the restoration margins using appropriate instruments for the polishing of composite resins. SHADES Translucent, A2, Bleach, Opaque STORAGE Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. CAUTION In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

5. FINAL POLISHING Polish the restoration margins using appropriate instruments for the polishing of composite resins. SHADES Translucent, A2, Bleach, Opaque STORAGE Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. CAUTION In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

5. FINAL POLISHING Polish the restoration margins using appropriate instruments for the polishing of composite resins. SHADES Translucent, A2, Bleach, Opaque STORAGE Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. CAUTION In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

5. FINAL POLISHING Polish the restoration margins using appropriate instruments for the polishing of composite resins. SHADES Translucent, A2, Bleach, Opaque STORAGE Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. CAUTION In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

5. FINAL POLISHING Polish the restoration margins using appropriate instruments for the polishing of composite resins. SHADES Translucent, A2, Bleach, Opaque STORAGE Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. CAUTION In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

5. FINAL POLISHING Polish the restoration margins using appropriate instruments for the polishing of composite resins. SHADES Translucent, A2, Bleach, Opaque STORAGE Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. CAUTION In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

6. CLEANING AND DESINFECTING. USE DELIVERY SYSTEMS TO AVOID CROSS-CONTAMINATION OF PATIENTS THIS DEVICE requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

6. CLEANING AND DESINFECTING. USE DELIVERY SYSTEMS TO AVOID CROSS-CONTAMINATION OF PATIENTS THIS DEVICE requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

6. CLEANING AND DESINFECTING. USE DELIVERY SYSTEMS TO AVOID CROSS-CONTAMINATION OF PATIENTS THIS DEVICE requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

6. CLEANING AND DESINFECTING. USE DELIVERY SYSTEMS TO AVOID CROSS-CONTAMINATION OF PATIENTS THIS DEVICE requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

6. CLEANING AND DESINFECTING. USE DELIVERY SYSTEMS TO AVOID CROSS-CONTAMINATION OF PATIENTS THIS DEVICE requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

6. CLEANING AND DESINFECTING. USE DELIVERY SYSTEMS TO AVOID CROSS-CONTAMINATION OF PATIENTS THIS DEVICE requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

7. REMOVAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

7. REMOVAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

7. REMOVAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

7. REMOVAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

7. REMOVAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

7. REMOVAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

8. DISPOSAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

8. DISPOSAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

8. DISPOSAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

8. DISPOSAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

8. DISPOSAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

8. DISPOSAL OF REMAINS OF THE PRODUCT. DISINFECTING. DISINFECTANT INSTRUCTIONS. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines. Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you of this product, including those not listed in this instruction for use, please inform us immediately through the relevant vigilance system by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

EU / G-CORPORATION S.p.A. Via S. Maria Goretti, 5 - 10136 Torino - Italy. Tel: +39 011 220123000. www.gceurope.com

EU / G-CORPORATION S.p.A. Via S. Maria Goretti, 5 - 10136 Torino - Italy. Tel: +39 011 220123000. www.gceurope.com

EU / G-CORPORATION S.p.A. Via S. Maria Goretti, 5 - 10136 Torino - Italy. Tel: +39 011 220123000. www.gceurope.com

EU / G-CORPORATION S.p.A. Via S. Maria Goretti, 5 - 10136 Torino - Italy. Tel: +39 011 220123000. www.gceurope.com

EU / G-CORPORATION S.p.A. Via S. Maria Goretti, 5 - 10136 Torino - Italy. Tel: +39 011 220123000. www.gceurope.com


EU / G-CORPORATION S.p.A. Via S. Maria Goretti, 5 - 10136 Torino - Italy. Tel: +39 011 220123000. www.gceurope.com



Les bruksanvisningen nøye før bruk.



Πριν από την χρήση παρακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.



Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização.



Läs bruksanvisningen noggrant före användning.



Læs bruksanvisningen omhyggeligt gennem før brug.



Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

G-CEM™ Veneer VALOKOVETEMIN ADHESIIVIN HYDROFILMUOVIVEMENTTI

Ansoatan hammashuolto ammattilaisten käytön suositteleissa käyttötilaisuuksissa.
Suositellut käyttöindikaatit
Alle 2,0 mm paksuudella valmistettujen laminaattien sekä inlay- ja onlay-tietyt adhesiivien sementointiin silikon, kun liipukaivutissa mahdollista sementin valokovettamisen keinoin.
KÄYTTÖINDEKSI
1. Direkte suppleveringsgruppen til patienter med kendt allergi overfor methakrylat monomer eller methakrylat polymer.
2. Undgå brug af produktet til patienter med kendt allergi overfor methakrylat monomer eller methakrylat polymer.
SALEDES ANVENDES G-CEM Veneer SPRÜTTE
i. Hold sprøjten oppe og fjern skrukehætte ved at dreje det med uret.
ii. Fæst hurtigt og sikket appliceringsspidsen på sprøjten ved at dreje den med uret.
iii. Monter sprøjtespidsenheden, indtil sprøjten skal anvendes.
OBS:
i. Pæs på ikke at sætte appliceringspidsen for fast. Dette kan ødelægge skrøbeligheden. For at sikre at kontakt er det vigtigste, at sprøjten holdes for en overkørsel.
ii. For at fjerne eventuel lugt, fangelag appliceringspidsen, pres da forsigtigt på sprøjten, mens den holdes lodret. (pålø materiale till appliceringspidsens åbning. (Abb. 2)
iii. Hvis materialet ikke kommer ud på dispsiden og doser direkte fra sprøjten.
iv. Måske kommer luft med omgivende lys. Lys kan forårsage arbejdsskade.
v. Efter anvendelse fjernes appliceringspidsen og sprøjten påsættes skrukehætte.
CEMENTERINGSPROSEDUR AF FACADER, INDLÆG OG ONLAYS I INDRYBNING AF RESTAURERINGEN
i) Fjern den provisoriske restaurering og rens den præparerede tand med en børstebørste og pimpsten og fjern resterne af provisorisk cement.
ii) Kontrolér påflor, farve og okklusion på den endelige restaurering. Om nødvendigt brug G-CEM Try-In-Paste (Indrybningspaste).
OBS: SALEDES ANVENDES G-CEM Try-In-Paste
i) Få et tyndt spændt pappaport eller et stykke med uret.
ii. Sæt appliceringspidsen sikket fast på sprøjten ved at dreje den med uret.
iii. G-CEM Try-In-Paste appliceres på restaureringsindvænet overflade og placeres på præparationen.
iv. Sæt hæften på straks efter brug.
v. Kontrollér i behandlingsrummet og æstetik.
vi. Forsæt sprutning ommedelt efter anvendelse.
vii. Kontrollér påflor og æstetik for den færdige restaureringen. v. Kontrollér at G-CEM LinkForce Try-In-Paste helt afsløret i nylon burj bånd efter gennemkvarnde pasta skal lade til indbindingsstyrke.
2. FORBEHANDLING AF RESTAURERINGEN
i) Vær omhyggelig med både restaureringen i henhold til producentens anvisninger.
ii) Glaskeramisk press med fusyre 10 sekunder på lithumdiskalitet (g. GC Initial LRF BLOCK) og 60 sekunder på feltspatisk og leucitfaskerisk keramik (g. GC Initial LRF BLOCK). Skyl grundigt med vand og tørlæg med trykluft.
iii) Zirkonium, alumin, hydroxideram (g. CERASMARKT270) og komposit: sandblæsning og blæsning af resterne af resterne. Tørlægning nognagt med ultralyd. Skyl grundigt med vand og tørlæg med olietuft. OBS: I følge producentens anvisninger for parametre af sandblæsning og trykluft.
iv) CerAMARKT270: Hvis sandblæsning ikke er en mulighed kan der ættes med fusyre i 60 sekunder.
v) Applicér G-Multi PRIMER på restaureringsindvænet overflade og tørlæg med trykluft.
vi) Applicér G-PreMO BOND på restaureringsindvænet overflade. Vent 10 sekunder.
3. FORBEHANDLING AF PRÆPARATIONEN
i) Rens præparationen med pimpsten og vand. Tør forsigtigt ved at blæse med olietuft ind i restaureringsindvænet.
ii) Vælg en af følgende to metode:
a) Selektiv ætning af emalje og 35-40% fosforlyseffekt (g. GC ECTCHANT) 10-15 sekunder, skyl i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
b) Totalætsning af emalje og 35-40% fosforlyseffekt (g. GC ECTCHANT) 10-15 sekunder, skyl i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt. Både emalje og dentin ættes med 35-40% fosforlyseffekt (g. GC ECTCHANT) 10-15 sekunder, skyl i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
iii) Totalætsning af emalje og 35-40% fosforlyseffekt (g. GC ECTCHANT) 10-15 sekunder, skyl i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
iv) Etape emalje og dentin med 35-40% fosforlyseffekt (g. GC ECTCHANT) 10-15 sekunder, skyl i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
v) Applcér G-PreMO Bond på den præparerede overflade. Læg varen under 10-15 sekunder og tørlæg med olietuft luft med MAXIMAL LUFFTRYK.
vi) Applcér G-PreMO Bond på den præparerede overflade. Læg varen under 10-15 sekunder og tørlæg med olietuft luft med MAXIMAL LUFFTRYK.
vii) I recomenderer at anvende kofferlam.
viii) Sænkere til MAXIMAL LUFFTRYK anvendes for at minimere brugen af energi.
ix) Vær omhyggelig med håndled og hænder.
x) Anvendelse under bindingsforhold, henvises til producentens brugvejledning. Lyshærdning af adhesivet anbefales for at opnå optimal bindingsstyrke.
xi) Tilmeldt med polymeriseringslampe. Se Tabel 1 for hærdeinstruktioner.
OBS:
i. Lyshærdning underlignegenhærdet for effektiv bindingsstyrke. Lavere brugen af energi.
ii. Anvendelse under bindingsforhold, henvises til producentens brugvejledning. Lyshærdning af adhesivet anbefales for at opnå optimal bindingsstyrke.
Tabel 1 - G-PreMO BOND Hærdetid

	Hærdetid	Afstand fra lyskilden spids
Polymeriseringslampe	< 10 mm	> 10 mm
HalogenLED >700 mW/cm ²	10 sek.	20 sek.
High Power LED >1,200 mW/cm ²	5 sek.	10 sek.

4. CEMENTERING
i) Dæk restaureringsindvænet overflade med tilstrækkelig cement.
OBS:
i. Eksposering af kraftigt lys bør undgås under applikationen, da det reducerer æstetikken.
ii) Placer straks et beskyttende instrument. Udvalgt moderat tryk.
iii) Kontrolér at G-CEM Veneer fylder uti alle områder af præparationen.
iv) Cementoverkødet fjernes efter en af følgende teknikker:
1. Fasthæft et moderat tryk og fjern overkødet cement ved hjælp af en pensel. Særg for at cement fjernes grundigt fra svært tilgængelige områder (eks. approximale keramik).
2. Fjern resterne af cementet ved hjælp af en ætning af resterne af resterne.
3. Fjern resterne af cementet ved hjælp af ultralyd med et egnet instrument. At opnå en god konsistens, til at fjerne overkødet, afhænger af den samlede cementtykkelse.
4. Anvendelse af et egnet instrument til at fjerne resterne i den mere avancerede og niche-facader. Når den overskydende cement skånsomt fjernes med en pensel eller gaze i retning med sprøjten.
5. D-Light Gun kan anvendes i detection mode for at opdage eventuel efterladt cement eller forudsigt.
6. Særg for at præparationen er tør efter anvendelsen med polymeriseringslampe, mens det moderate tryk opretholdes. Se Tabel 2 for hærdeinstruktioner.
Tabel 2 - G-CEM Veneer Hærdetid

Polymeriseringslampe	Hærdetid
HalogenLED >700 mW/cm ²	20 sek.
High Power LED >1,200 mW/cm ²	10 sek.

OBS:
i. For at undgå lighærdning under præparationsfasen, kan disse dækkes med en glycerinløg, før den endelige hærdning.
5. ENDELIG FINISHERING
Poler restaureringsytterne yders grænser med egnede instrumenter til polering af sensibleres kompositter.
FAVER
Transparent, A2, Bleach, Opaque
OPBEVARING
For optimal result skal materialet opbevares køligt og mørkt (4-25 °C / 39,2-77,0 °F). Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
ADVARSEL
I tabellerne hudkontakt eller kontakt med oral væv. Fjernes materialet med vand/et eller svamp med alkohol. Der skylles grundigt med vand. Vi anbefaler at anvende kofferlam og/eller COCOA BUTTER, som isolering af operationsområdet.
2. I tilfælde af, at materialet kommer i kontakt med øjne, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
3. Vær opmærksom på, at patienten ikke sluger materialet.
4. Blånd ikke materialet med andre lignede produkter.
5. Sprøjtespidsen skal rengøres grundigt.
6. Sprøjtespidsen skal rengøres grundigt.
7. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
8. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
9. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
10. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
11. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
12. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
13. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
14. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
15. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
16. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
17. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
18. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
19. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
20. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
21. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
22. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
23. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
24. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
25. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
26. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
27. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
28. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
29. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
30. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
31. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
32. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
33. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
34. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
35. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
36. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
37. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
38. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
39. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
40. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
41. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
42. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
43. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
44. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
45. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
46. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
47. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
48. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
49. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
50. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
51. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
52. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
53. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
54. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
55. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
56. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
57. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
58. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
59. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
60. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
61. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
62. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
63. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
64. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
65. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
66. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
67. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
68. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
69. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
70. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
71. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
72. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
73. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
74. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
75. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
76. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
77. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
78. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
79. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
80. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
81. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
82. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
83. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
84. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
85. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
86. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
87. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
88. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
89. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
90. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
91. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
92. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
93. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
94. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
95. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
96. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
97. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
98. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
99. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
100. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
101. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
102. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
103. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
104. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
105. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
106. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
107. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
108. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
109. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
110. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
111. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
112. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
113. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
114. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
115. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
116. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
117. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
118. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
119. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
120. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
121. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
122. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
123. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
124. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
125. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
126. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
127. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
128. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
129. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
130. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
131. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
132. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
133. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
134. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
135. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
136. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
137. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
138. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
139. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
140. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
141. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
142. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
143. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
144. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
145. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
146. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
147. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
148. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
149. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
150. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
151. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
152. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
153. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
154. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
155. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
156. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
157. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
158. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
159. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
160. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
161. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
162. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
163. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
164. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
165. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
166. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
167. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
168. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
169. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
170. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
171. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
172. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
173. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
174. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
175. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
176. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
177. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
178. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
179. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
180. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
181. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
182. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
183. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
184. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
185. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
186. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
187. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
188. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
189. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
190. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
191. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
192. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
193. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
194. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
195. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
196. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
197. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
198. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
199. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
200. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
201. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
202. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
203. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
204. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
205. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
206. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
207. Ved polering af materialer, brug svampeske for at undgå inhalering af støvpartikler.
208. I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument eller bomuldspindel for tørlig.
209. Anvend ikke G-CEM Veneer i kombination med eugenoldholdige materialer, da eugenol kan forårsage tilfældig polymerisering. Advarsel: Ikke G-CEM Veneer i kombination med materialer, såsom bindevævs (H₂O₂), da H₂O₂ kan forårsage G-CEM Veneer i et hærdt eller blødt tilfælde.
210. Aspirir ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelse af sprøjten.
211. Bortskælføle af reproduktorer skal behandle til lokale regulativet.
212. I sværlige tilfælde kan en sensibiliserings fra produktet opstå. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugeren af produktet indstilles og patienten henvises til egen læge.
213. Personlige vækstmødder (PFE) skal fjernes grundigt.
214. Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergiske reaktioner.
215. Brug beskyttelseslignende under hærdning.
216. Ved polering af materialer,